

FREESTYLE LIBRELINK APP¹


DISPONIBILE

NUOVO AGGIORNAMENTO

**Ancora più preciso fin dal
primo giorno²**

Maggiori informazioni sull'aggiornamento su
www.FreeStyleLibre.com/app

Aggiorna ora

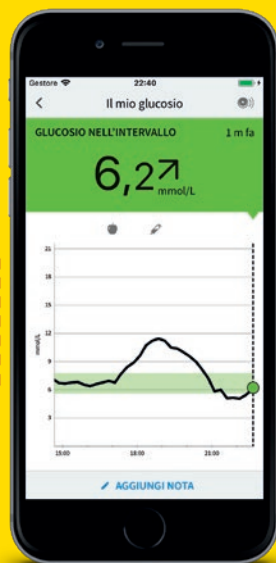

Scarica su
App Store



DISPONIBILE SU
Google Play


FreeStyle
LibreLink



life. to the fullest.

Abbott

I vantaggi per me:

- Ancora più preciso fin dal primo giorno di utilizzo.²
- Ancora più preciso per l'intero periodo di applicazione del sensore.²
- Il tempo di associazione esteso consente di associare il proprio smartphone e il sensore FreeStyle Libre fino all'ultimo giorno di funzionamento di quest'ultimo.

Quando aggiornare la app FreeStyle LibreLink¹?

Può aggiornare la app FreeStyle LibreLink¹ dove e quando vuole, anche se utilizza un sensore. Dopo aver aggiornato la app, ogni sensore che userà in futuro darà letture ancora più precise².

Che cosa significa 'letture ancora più precise'?

La maggiore precisione dei valori misurati² favorisce la scelta della terapia più appropriata con la facilità che è tipica di FreeStyle Libre.

Che succede se utilizzo il lettore FreeStyle Libre insieme alla app FreeStyle LibreLink¹?

Se si usano sia il lettore FreeStyle Libre sia la app FreeStyle LibreLink¹, si deve innanzitutto assicurarsi di aver aggiornato ambedue i dispositivi.**



L'aggiornamento del lettore è disponibile alla pagina: www.FreeStyleLibre.com/update



L'aggiornamento della app FreeStyle LibreLink¹ è disponibile sull'App Store o su Google Play Store. Maggiori informazioni sull'aggiornamento sono disponibili sul sito: www.FreeStyleLibre.com/app

*La app FreeStyle LibreLink e il lettore FreeStyle Libre hanno funzioni simili, ma non identiche.

**NOTA: Se si usano contemporaneamente il lettore E la app e i due dispositivi non sono aggiornati, è possibile che i valori misurati del glucosio non coincidano.

- 1 La app FreeStyle LibreLink è stata sviluppata per smartphone che supportano la tecnologia NFC con sistema operativo Android, nella versione 5.0 (Lollipop) o superiore, e per iPhone con iOS versione 11 o superiore (iPhone 7.0 o più recente). L'uso di FreeStyle LibreLink richiede la registrazione su LibreView, un servizio offerto da Abbott e Newyu Inc.
- 2 Relazione sullo studio clinico ADC-US-VAL-17166: FreeStyle Libre Flash Glucose Monitoring System Accuracy Study (studio sulla precisione del sistema di monitoraggio flash del glucosio FreeStyle Libre); lo studio è stato condotto su 95 adulti; relazione sullo studio clinico ADC-US-VAL-17167: Effectiveness and Safety Study of the FreeStyle Libre Flash Glucose Monitoring System in Pediatric Populations (studio di efficacia e sicurezza del sistema di monitoraggio flash del glucosio FreeStyle Libre in popolazioni pediatriche); lo studio è stato condotto con 74 soggetti (fascia di età: 4-17 anni). I dati di ambedue gli studi sono disponibili in Diabetes Care di Abbott e sono consultabili alla pagina <https://freestyle.de/accuracy-of-freestyle-libre-2>.
- 3 Se i valori del glucosio cambiano rapidamente, è necessario verificarli ulteriormente con un glucometro, perché i valori del glucosio misurati nel fluido interstiziale potrebbero non corrispondere esattamente ai livelli ematici, oppure nel caso in cui il sistema rilevi un'ipoglicemia o un'ipoglicemia incipiente oppure i sintomi non corrispondono ai valori misurati dal sistema.

FreeStyle, Libre e i nomi di marchi collegati sono marchi registrati di Abbott Diabetes Care Inc. in vari paesi. Altri nomi di marchi sono di proprietà dei rispettivi produttori. Apple e il logo Apple sono marchi di Apple Inc., con sede negli USA e in altri paesi. App Store è un marchio di Apple Inc. Google Play e il logo Google Play sono marchi di Google Inc.

© 2019 Abbott Diabetes Care | ADC-2019-CH-0314 | Maggio 2019 | sense & image